



MUSTER | QR-Code zur öffentlichen Mustervorschau

Gegenstand / Prüfling:

Typ: Digi-04

Seriennummer: 25020604230005

Messbereich: 0 bis 10 bar

Genauigkeitsklasse: 0,40 %

Test Medium / Temp.: Luft (18 bis 22°C)

Durchschnittswerte aus Messreihen: 6

Empfohlene Rekalibrierung: 09.2027

Kunde:

Muster Anlagenbau GmbH

Verwendetes Referenznormal:

Gerät: DM-01 0-10bar (SN: 11610137)

Zertifikat Nr.: 1767

Klasse vom Referenznormal: 0,05 %


Bemerkung:

Mustergerät zur Demonstration des Zeugnisportals.
Einsatzort: Prüfstand 2, Anlage Druckluftversorgung.

Skalenwert in bar	Aufwärts gemessen in bar	Abweichung in in bar	Abwärts gemessen in bar	Abweichung in in bar
2	2,004	0,004	2,005	0,005
3	3,006	0,006	3,007	0,007
5	5,006	0,006	5,008	0,008
6	6,005	0,005	6,009	0,009
8	8,009	0,009	8,014	0,014
10	10,007	0,007	10,014	0,014

Gemessene Maximalabweichung	Zulässiger Grenzwert	Prüfbefund
0,014 bar	±0,040 bar	Angegebene Genauigkeitsklasse eingehalten

Abweichungskurve in bar

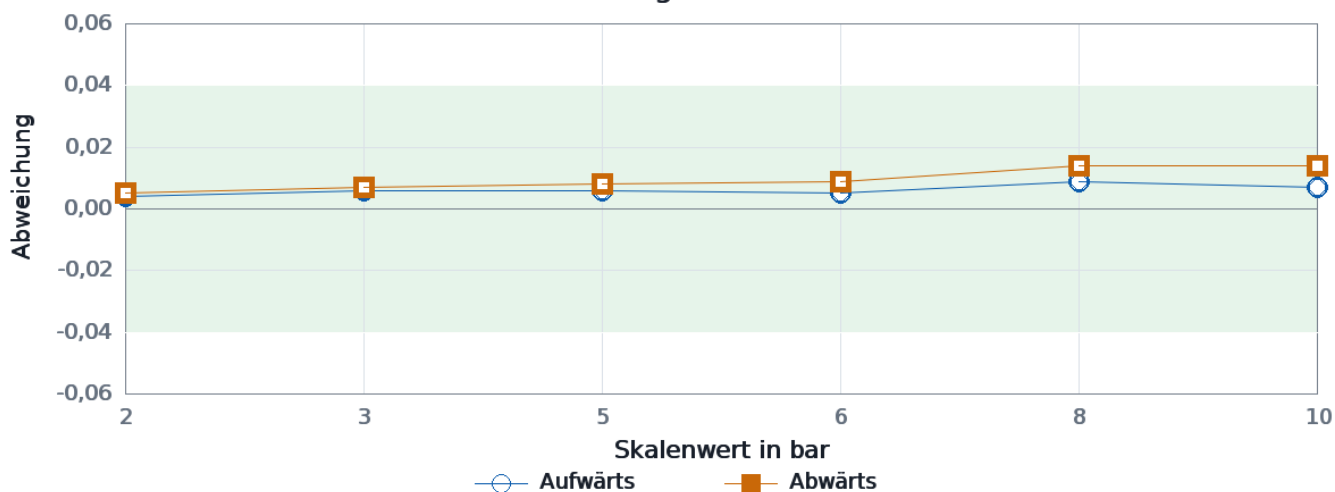

Unterschrift:

Prüfer: Andreas Bondza